

## Horloge Digitale Hôpital

Style OP 5S

### Description :

- ▶ Horloge d'intérieur lumineuse à diodes.
- ▶ Principalement destiné à l'usage des salles d'opération dans les hôpitaux.
- ▶ Affichage heure fixe ou en alternance, avec la date ou le numéro de semaine, ou affichage du chronomètre.
- ▶ Hauteur des chiffres 5 cm, lecture jusqu'à 20 mètres.
- ▶ Couleurs de diodes : rouge.
- ▶ Boîtier inox pour l'horloge et le pupitre conforme aux exigences de nettoyage.
- ▶ Versions : DHF, réceptrice impulsion minute 24V ou réceptrice temps codé AFNOR.


### Caractéristiques techniques de l'horloge :

- ▶ Boîtier INOX (IP54), avec verre diffusant minéral.
- ▶ Fixation par encastrement mural avec 4 trous fraisés Ø4 mm (vis non fournies).
- ▶ Réglage de la luminosité sur 4 niveaux.
- ▶ Angle de lecture 120°.
- ▶ Fonctionnement silencieux.
- ▶ 2 boutons de réglage et de programmation.
- ▶ Chiffres constitués de 7 segments de 3 diodes.
- ▶ Alimentation 230V ±10%, 50/60 Hz.
- ▶ Consommation : 55 mA.
- ▶ Température de fonctionnement : de -5 à 50°C.
- ▶ Poids : 3 Kg.



### Caractéristiques techniques du pupitre :

- ▶ Chronomètre heure - minute - seconde de 0 à 23 : 59 : 59.
- ▶ Montage par encastrement (vis non fournies).
- ▶ Pupitre étanche à touches affleurantes pour un nettoyage facile.
  - Une touche mode affichage de l'heure avec led de visualisation.
  - Une touche mode affichage du chronomètre avec led de visualisation.
  - Une touche start/stop : appui successif pour marche/arrêt du chronomètre.
  - Une touche reset : remise à zéro du chronomètre en mode stop.
- ▶ Raccordement à l'horloge par un câble SYT 2 paires 5/10 d'une longueur maxi de 20 m.
- ▶ Alimentation 12 VDC fournie par l'horloge.
- ▶ Le pupitre peut commander jusqu'à 10 horloges maximum.
- ▶ Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
- ▶ Indice de protection : face avant IP55.
- ▶ Poids : 255g.

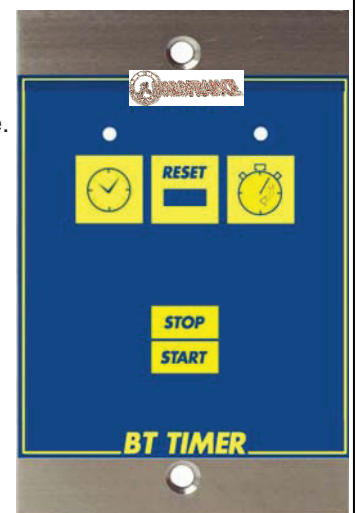

### Normes :


- ▶ Norme NF EN50081-1 : norme générique émission
- ▶ Norme NF EN50082-1 : norme générique immunité
- ▶ Norme NF EN60950 : sécurité des appareils de traitement de l'information.

### Références :

- |  |        |
|--|--------|
| ▶ Style OP 5S rouge indépendante / réceptrice impulsions | 936211 |
| ▶ Style OP 5S rouge indép. / réceptrice sans pupitre     | 936231 |
| ▶ Style OP 5S rouge AFNOR                                | 936221 |
| ▶ Style OP 5S rouge AFNOR sans pupitre                   | 936241 |
| ▶ Style OP 5S rouge DHF                                  | 936281 |
| ▶ Style OP 5S rouge DHF sans pupitre                     | 936271 |

**HOROFRANCE**  
BP 423 - 85504 LES HERBIERS  
Tél. 02 51 64 81 15  
Fax 02 51 71 60 37

### Dimensions du pupitre :

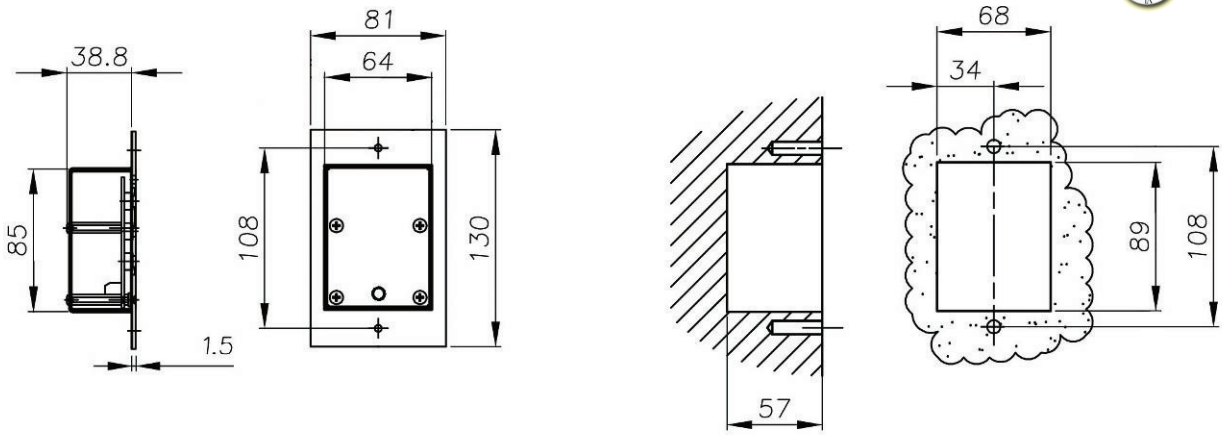

### Dimensions de l'horloge :

